

タクシメーターに係る施行、経過措置について

特定計量器検定検査規則(附則)

1. 施行期日


新基準による型式承認、検定の開始


2. 基準改正による経過措置

旧型式品の製造期限

3. 旧基準品の装置検査終了

旧基準品の装置検査合格品の使用期限

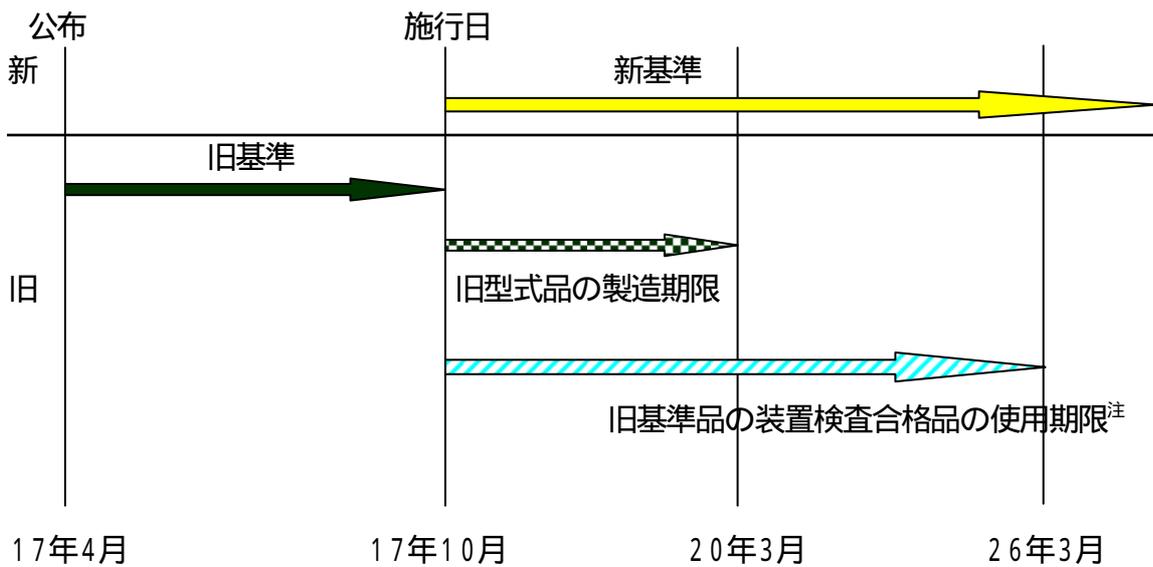

- 新基準による型式承認、検定の開始 
- 旧型式品の製造期限 
- 旧基準品の装置検査合格品の使用期限^注 


注)旧型式タクシメーターであって平成26年3月31日までに装置検査の申請をしてこれに合格したタクシメーターについては、当該タクシメーターの装置検査証印の有効期間満了まで使用できるものとする。

非自動はかりに係る施行日について

特定計量器検定検査規則(附則)

1. 施行日

平成 17 年 7 月 1 日

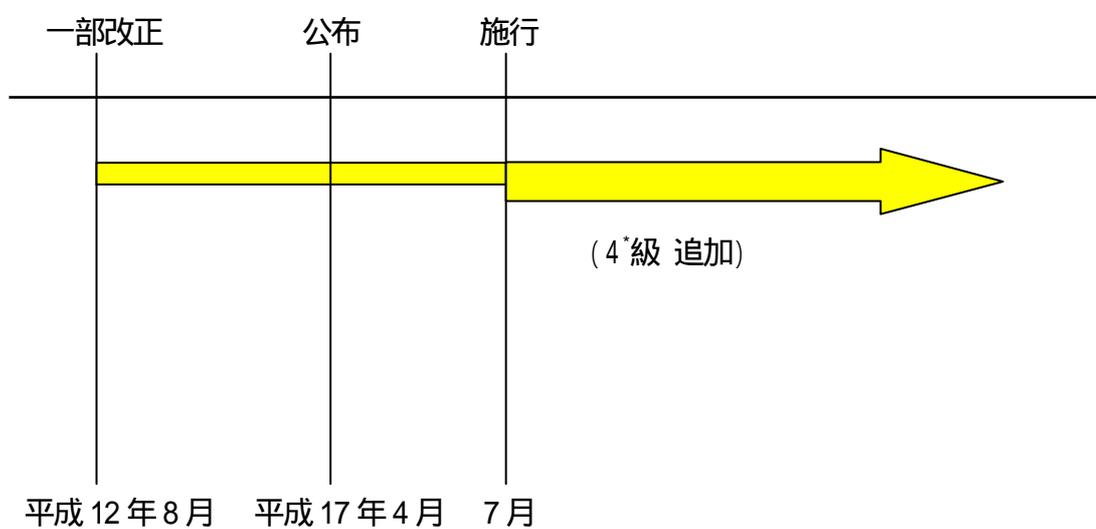

抵抗体温計に係る施行、経過措置について

特定計量器検定検査規則(附則)

1. 施行期日


新基準による型式承認、検定の開始(旧基準廃止)

2. 基準改正による経過措置

旧型式品の製造期限(検則改正前に型式が承認されている型式の製造期限)

3. 旧型式品の使用期限

旧基準検定合格品の使用期限

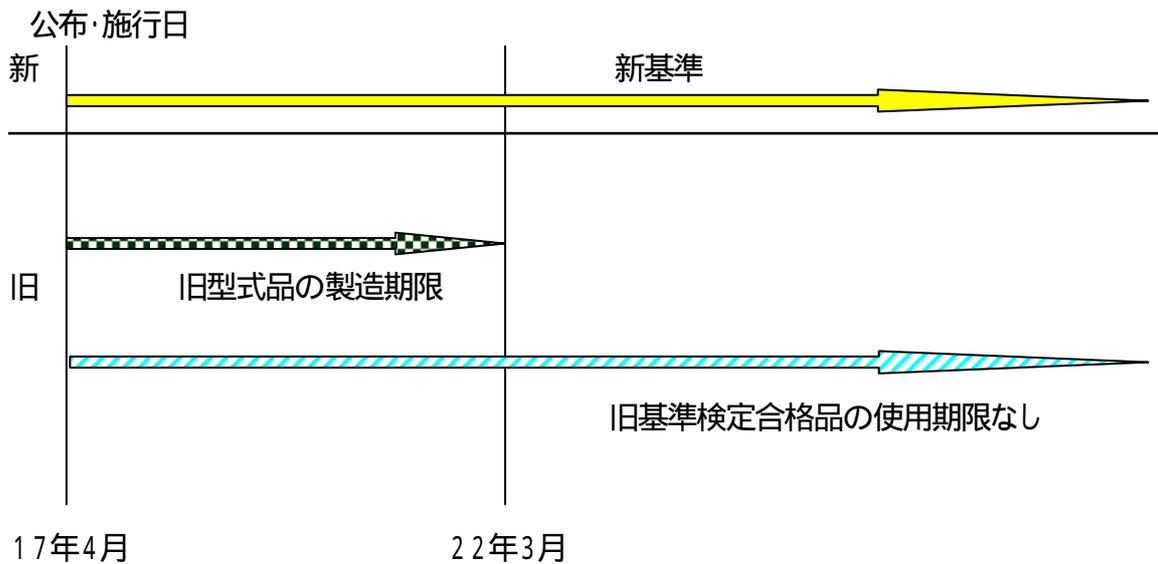

新基準による型式承認、検定の開始 →

旧型式品の製造期限 →

旧基準検定合格品の使用期限 →

水道メーター及び温水メーターに係る施行、経過措置について

特定計量器検定検査規則(附則)

1. 施行期日


新基準による型式承認、検定の開始(旧基準廃止)

2. 基準改正による経過措置

旧型式品の製造期限

3. 旧基準品の使用期限

旧基準検定合格品の使用期限

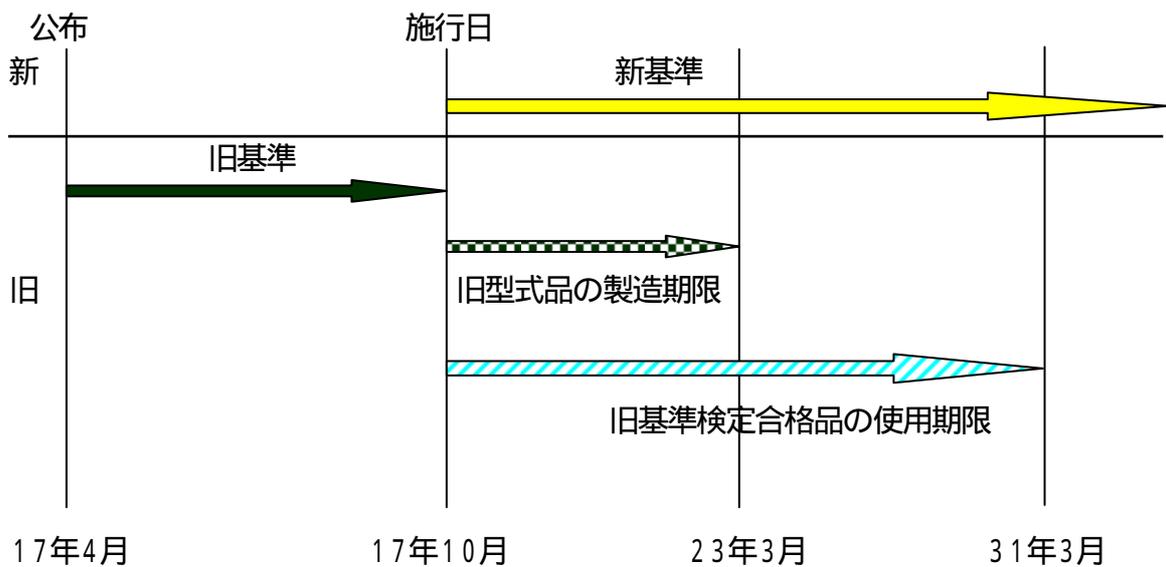

新基準による型式承認、検定の開始 

旧型式品の製造期限 

旧基準検定合格品の使用期限 

電気式アネロイド型血圧計に係る施行、経過措置について

特定計量器検定検査規則(附則)

1. 施行期日


新基準による型式承認、検定の開始

2. 基準改正による経過措置

旧型式品の製造期限(検則改正前に型式が承認されている型式の製造期限)

3. 旧基準品の使用期限

旧基準検定合格品の使用期限

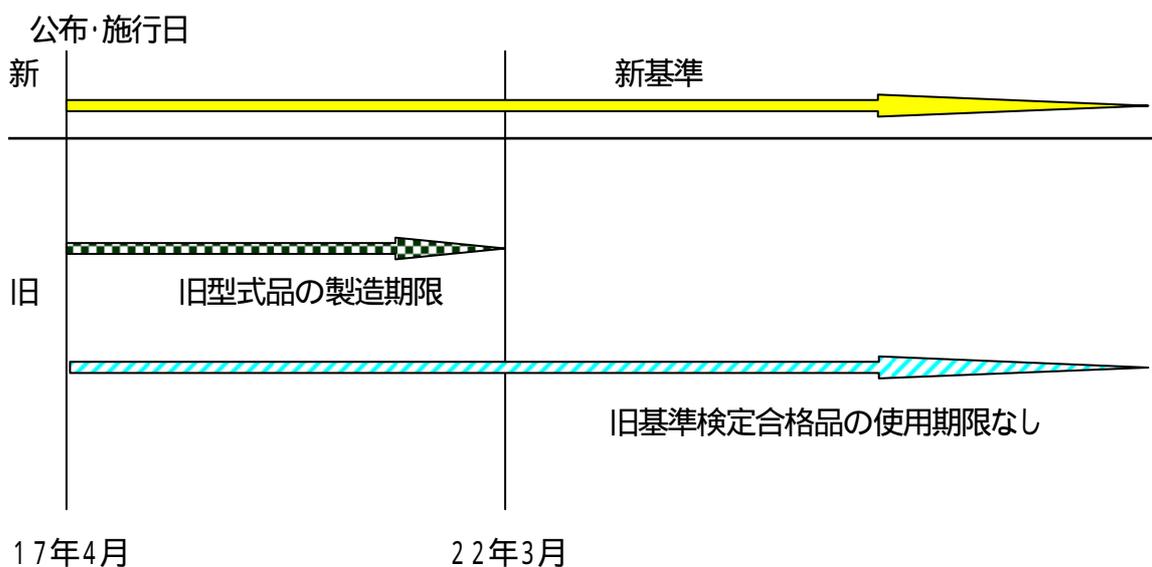

新基準による型式承認、検定の開始 →

旧型式品の製造期限 →

旧基準検定合格品の使用期限 →